

Hypro-Sorb® M

ČESKY
Návod k používání
dvojfázová biologicky vstřebatelná matrice
na riadenú tkanavou a kostnú regeneráciu

Něžadoucí účinek
U osob citlivých na bovinou blikvinku není vyloučena alergická reakcia na implantiovaný Hypro-Sorb M, i když dosud nebyla klinicky pozorována.

Způsob použití

1. Hypro-Sorb M upravte nůžkami na požadovanou velikost.
2. Membránu M přešroubat okrajem defektu nejméně 2-3 mm, aby se dosáhlo úplného pokrytí kosti a zábranu laterálnemu vrstvení tkáně.
3. Dutina defektu je pak vyplňena substitučním kostním materiálem, jak je Hypro-Oss, je-li indikovaná.

4. Membránu Hypo-Sorb M je aplikována přes defectu svojí hladkou stranou nahoru a mírně přitlačena, aby držela na místě. Rychle nasycené membrány krví a exudátum umožní perfektní přizpůsobení povrchu kosti.

5. Chlopňu S ošívá působností nedlouho, ale bez napětí (např. použitím jednoduchého alebo matracového stehu). Rana by měla být pokud možno úplně uzavřena.

6. Během fáze hojení se v oblasti rány mělo zamepit z prostetiky, nebo ohmatnout. Intenzívni orální hygiena by měla být zaměřena antibakteriálně vyplachováním (např. chlorhexidinem) po asi 3 týdnech. Terapie antibiotiky může být předepsána podle uvážení lekaře.

Postoperační péče

V případě otevření rany a odkrytí membrány je doporučeno obvyklé antiseptické ošetření. Vymýtí membrány není nutné. Rychlost resoruce může být urychlena využitím vnitřních vlníku jako je salinita, atd. Vlastnosti kolagenu mohou přizpůsobit hojení i rozvěření rany.

Doba použitelnosti

Datum expirace je uvedeno na každém jednotlivém balení. Hypo-Sorb M s prodlouženou datou expirace nesmí být používán.

Skladování

Hypo-Sorb M musí být skladován při teplotách od -25°C do +50°C na suchém místě, chráněném před průměrným slunečním světlem.

Bezpečná likvidace

Zbyly Hypo-Sorb M musí být zlikvidován v nemocničním odpadu.

Klasifikace

Hypo-Sorb M je zdravotnický prostředek třídy III.

Odpovědný celosvětový distributor

Bioimplon GmbH, Friedrich-List-Str. 27, 35398 Giessen, Spolková republika Německo, tel. +49 641-68681123, fax +49 641-68681124, email: info@bioimplon.de, www.bioimplon.com.

Odpovědný výrobce


Hypo s.r.o., čp. 137, 763 61 Komárov, Česká republika, E.U., tel. +420 577159727, fax +420 577159724, www.hypo.cz.

Rozměry

Hypo-Sorb M je hromadně vyráběn pod označením:

Kat. č.	Rozměry	Počet kusů v balení	Kat. č.	Rozměry	Počet kusů v balení
030	16 x 20 x 0,8 mm	1	046	100 x 100 x 2 mm	1
031	22 x 32 x 0,8 mm	1	047	100 x 125 x 2 mm	1
032	32 x 42 x 0,8 mm	1	048	125 x 175 x 2 mm	1
035	16 x 20 x 0,3 mm	1	049	125 x 200 x 2 mm	1
036	22 x 32 x 0,3 mm	1	050	25 x 25 x 0,8 mm	1
037	32 x 42 x 0,3 mm	1	061	25 x 50 x 0,8 mm	1
038	20 x 25 x 2 mm	12	062	40 x 60 x 0,8 mm	1
039	20 x 25 x 2 mm	6	063	50 x 50 x 0,8 mm	1
040	25 x 25 x 2 mm	1	064	50 x 100 x 0,8 mm	1
041	25 x 50 x 2 mm	1	065	75 x 75 x 0,8 mm	1
042	40 x 60 x 2 mm	1	066	100 x 100 x 0,8 mm	1
043	50 x 50 x 2 mm	1	067	100 x 125 x 0,8 mm	1
044	50 x 100 x 1 mm	1	068	125 x 175 x 0,8 mm	1
045	75 x 75 x 2 mm	1	069	125 x 200 x 0,8 mm	1

Použité symboly

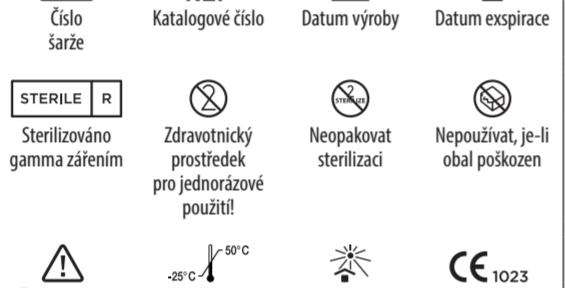

© 1.2015 Hypo s.r.o.

není použitelný v případě poškození obalu. V případě vizuálně zjištěného poškození obalu nelze Hypo-Sorb M použít! Po otevření nesporého materiálu nelze používat.

Upozornění Hypo-Sorb M je dodáván sterilní. Před otevřením zkontrolujte neporušenost obalu. V případě vizuálně zjištěného poškození obalu nelze Hypo-Sorb M použít! Po otevření nesporého materiálu nelze používat.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Cystektomie
- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Elevace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Cystektomie
- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Cystektomie
- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

Kontraindikace Hypo-Sorb M nesmí být vkládán do kostních defektů, ať už pojednou, ať už v komplexu.

Upozornění Hypo-Sorb M je v dnešní době rekonstruovat k tom, že se využívají optimální podmínky pro zavedení implantátu.

Indikace Membrany Hypo-Sorb M jsou používány v čelství chirurgii a implantologie v následujících aplikacích:

- Segmentální naruštání alveolárního výrůstku
- Eleveace dna sinusu
- Resekce kořenového vřchlku
- Vyplňování aleo pro odstranění v předprotetické chirurgické práci
- Periimplantáty
- Léčba furák
- Rozštěp rtu a patra

<